


DETECTOR de IMPLANTE VACUOLAR

NHC: 013
Sexo: HOMBRE Edad: 35

Fecha Expediente:
22-05-2024



ZONAS OBTENIDAS

Derecha

Temporal

Malar

● Nasolabial

Mandíbula

● Periocular

Izquierda

Temporal

Malar

● Nasolabial

Mandíbula




● Periocular

Central

Labio superior

Labio inferior


Glabela

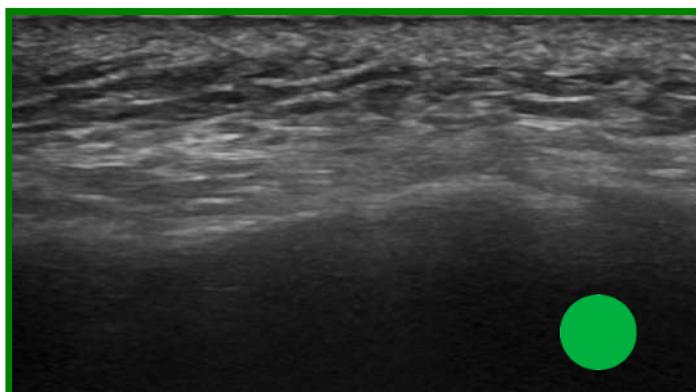

DETECTOR de IMPLANTE VACUOLAR

-  Presencia de implante vacuolar, valorar el ácido hialurónico como relleno más probable, a valorar con historia clínica y tiempo de implantación.
-  No hay presencia de implantes con patrón vacuolar, entre ellos el ácido hialurónico.

Dr Francisco de Cabo
colegiado: 080828853



Esta prueba de cribado detecta la presencia de implante con patrón vacuolar. No pretende ser un diagnóstico médico final, ni un pronóstico para tratamiento. Ha de ser el médico el que de el consejo apropiado, siendo incluso necesario la realización de otra complementaria prueba de imagen si la historia clínica o la sospecha de otras situaciones lo requiriesen.

BIBLIOGRAFÍA

- de Cabo et al. Ecografía de los materiales de relleno inyectables y su interés en el seguimiento diagnóstico. *Cir, plast Iberlatinoam*. 2012 Abr;38(2):179-187
- Urdiales F, de Cabo F, Bové I. Ultrasound patterns of different dermal. *J Cosmet Dermatol*. 2021 May;20(5):1541-1548