


## DETECTOR de IMPLANTE VACUOLAR

NHC: 3110\_1

Sexo: HOMBRE Edad: 58

Fecha Expediente:

29-11-2024

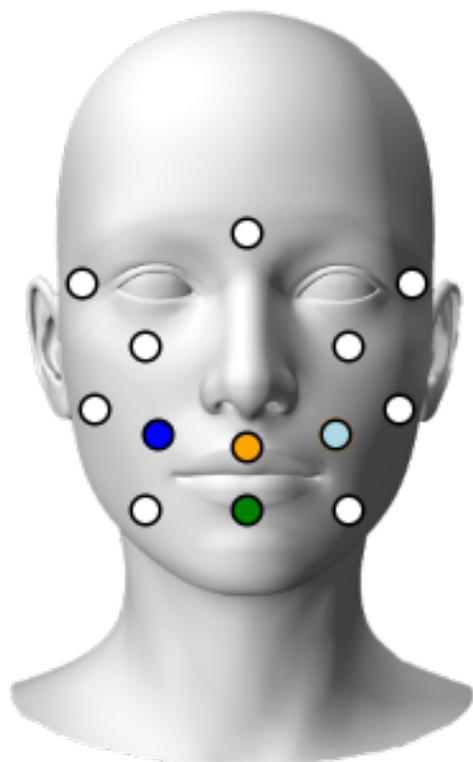

### ZONAS OBTENIDAS

#### Izquierda

Temporal

Malar

• Nasolabial

Mandíbula

Periocular

#### Derecha

Temporal

Malar

• Nasolabial

Mandíbula

Periocular




#### Central

• Labio superior

• Labio Inferior

Glabela



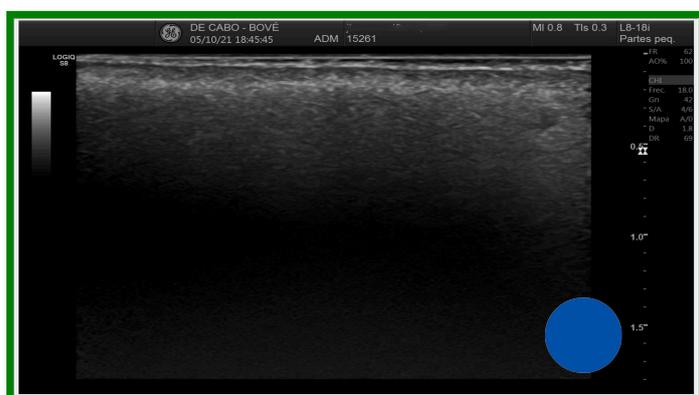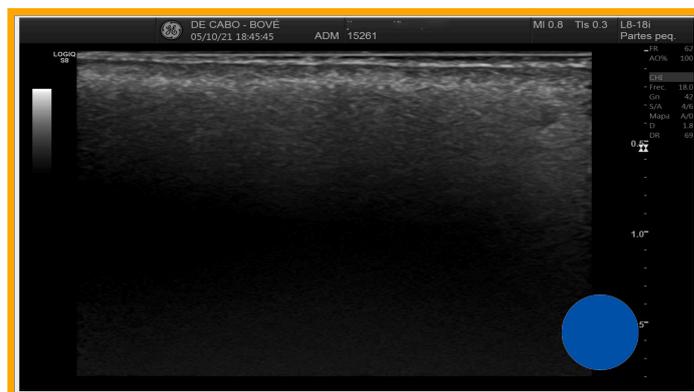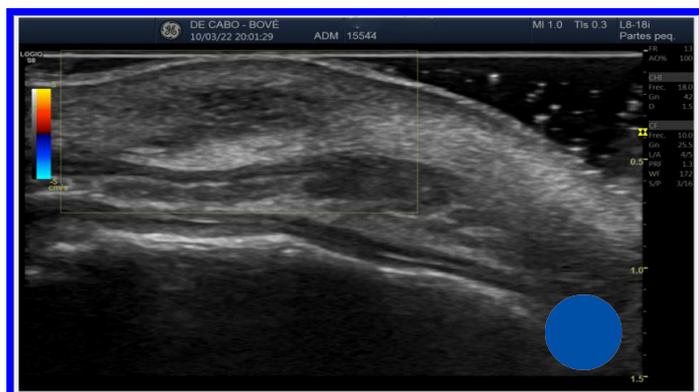

## DETECTOR de IMPLANTE VACUOLAR

- Presencia de implante vacuolar, valorar el ácido hialurónico como relleno más probable, a valorar con historia clínica y tiempo de implantación.
- No hay presencia de implantes con patrón vacuolar, entre ellos el ácido hialurónico.

Dr Francisco de Cabo  
colegiado: 080828853



*Esta prueba de cribado detecta la presencia de implante permanente de silicona fluida...*

### BIBLIOGRAFÍA

- de Cabo et al. *Ecografía de los materiales de relleno inyectables y su interés en el seguimiento diagnóstico. Cir, plastilberlatinoam. 2012 Abr;38(2):179-187*
- Urdiales F, de Cabo F, Bové I. *Ultrasound patterns of different dermal. J Cosmet Dermatol. 2021 May;20(5):1541-1548*

